一般的な注意　使用方法を含む注意事項

- ●カテーテル用テープ部のハガレ・浮き上がり・シワがないように貼付してください。また、貼付や患者の状態（意識の有無、治療の必要性の理解度、安静度、体動の有無や程度、留置部位等）を適宜観察・確認し、剥がれなどが発見された場合には、ただちに新しい本製品に貼りかえてください。
- ●皮膚に障害が発生する可能性がありますので、同一品の長期貼付は避け、適宜新しい本製品と交換してください。
- ●十分な固定力が得られない恐れがありますので、著しく乾燥している皮膚にはご使用にならないでください。
- ●汗・皮脂分・汚れ等により粘着力が低下する恐れがありますので、貼付部は清潔に保ってください。
- ●本製品は、水に濡れた状態および湿度の高い環境下では粘着力が低下する恐れがありますのでご使用にならないでください。
- ●本製品にベンジン・エタノール等の有機溶剤が付着すると粘着剤が溶解する事がありますので、有機溶剤の取扱いには十分ご注意ください。
- ●皮膚障害の原因となりますので、貼付の際は本製品を引っ張って貼付しないでください。
- ●本製品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ●ベーステープを皮膚から剥離する際は、皮膚が変形しないように皮膚を押さえながらゆっくりと剥がしてください。
- ●本製品の表面にはポリエチレンネットを使用しておりますので、高圧蒸気滅菌は避けてください。

廃棄上のご注意

- ●使用方法により、適切な廃棄を行ってください。

保管上のご注意

- ●水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。

種類と規格

種類	商品コードNo.	規　格		
		ベーステープ	カテーテル用テープ	適応カテーテルサイズ
N2号	19401	2.5cm×3.0cm	2.5cm×6.0cm	18Fr以下

ALCARE

アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800（代表）　FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

1310-1

for Best Care ALCARE

クイックフィックス®・N
Quickfix-N

カテーテル固定補助テープ
Catheter Fixation Assisted Tape

取扱説明書

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- ●常にこの取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室　0120-770175
www.alcare.co.jp

はじめに

〈クイックフィックス・N〉は、カテーテル・チューブ（以下カテーテル）管理において、従来、粘着テープで行われてきた、準備・加工・操作にかかる時間を軽減するための加工済みテープです。
クイックフィックス・Nは鼻挿入部のライン部固定補助を目的とし、設計されております。
皮膚貼付部とカテーテル貼付部が一体化した形状をしており、その粘着性はアクリル系粘着剤を使用した弊社伸縮性サージカルテープ（シルキーテックス・H）と同等程度です。
安全にお使いいただくために上記用途以外には使用せず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

＊［使用上のご注意］では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告　人身事故につながるおそれのある注意事項

- ●固定したカテーテルが継続的に皮膚に接触・圧迫していると潰瘍となる恐れがあります（特に鼻腔周辺部など）。適宜観察を行い、固定の位置や方向を変更してください。
- ●体動や体位交換などによりカテーテルに強い負荷がかかった場合、本製品の剥がれ及びカテーテルが抜ける危険があります。カテーテルに負荷がかからないように注意してください。

適応上の注意　製品特性上の注意事項

- ●本製品はアクリル系粘着剤を使用しており、シリコーン素材に対しては十分な固定力が得られない恐れがありますので、シリコーン製カテーテルの固定の際には十分ご注意ください。
- ●本製品には別記（種類と規格参照）の通り「適応カテーテルサイズ」があります。それらを守り、適切に本製品を使用してください。

各部の名称と構造

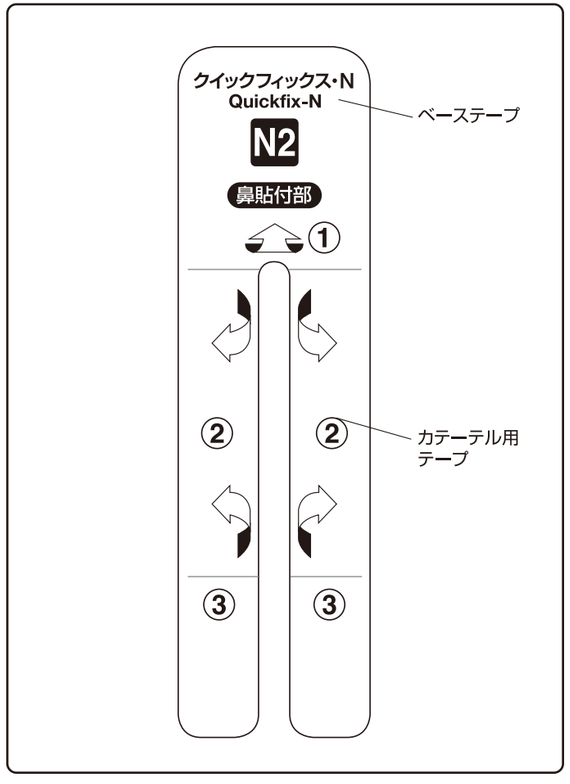

使用手順

1. ベーステープから剥離紙①を剥がし、鼻部に貼付します。

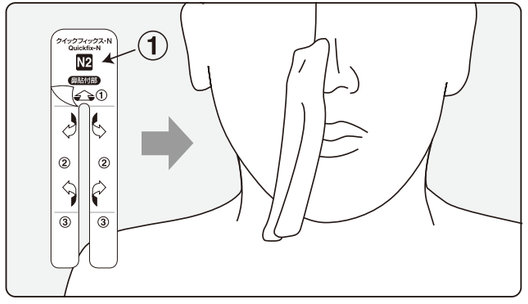

2. 片側のカテーテル用テープを剥離紙②から剥がし、カテーテルにらせん状に巻きつけるように貼付します。

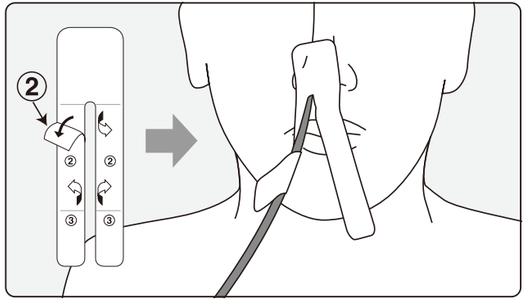

3. 同側の剥離紙③を剥がしカテーテルに貼付します。

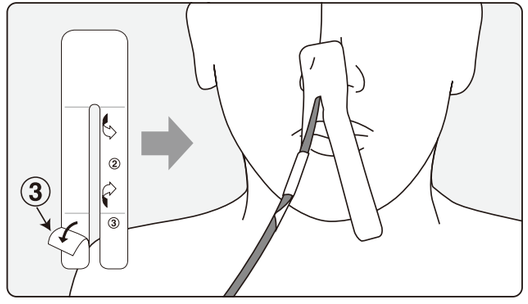

4. 使用手順2、3同様に、対側のカテーテル用テープを貼付します。

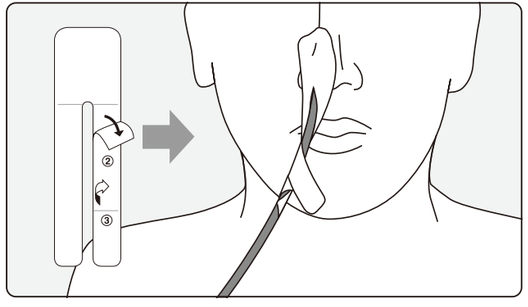

5. ルート部をクイックフィックスまたは粘着テープで固定してください。